

70歳代 女性

発熱 全身倦怠感


2011/4/29










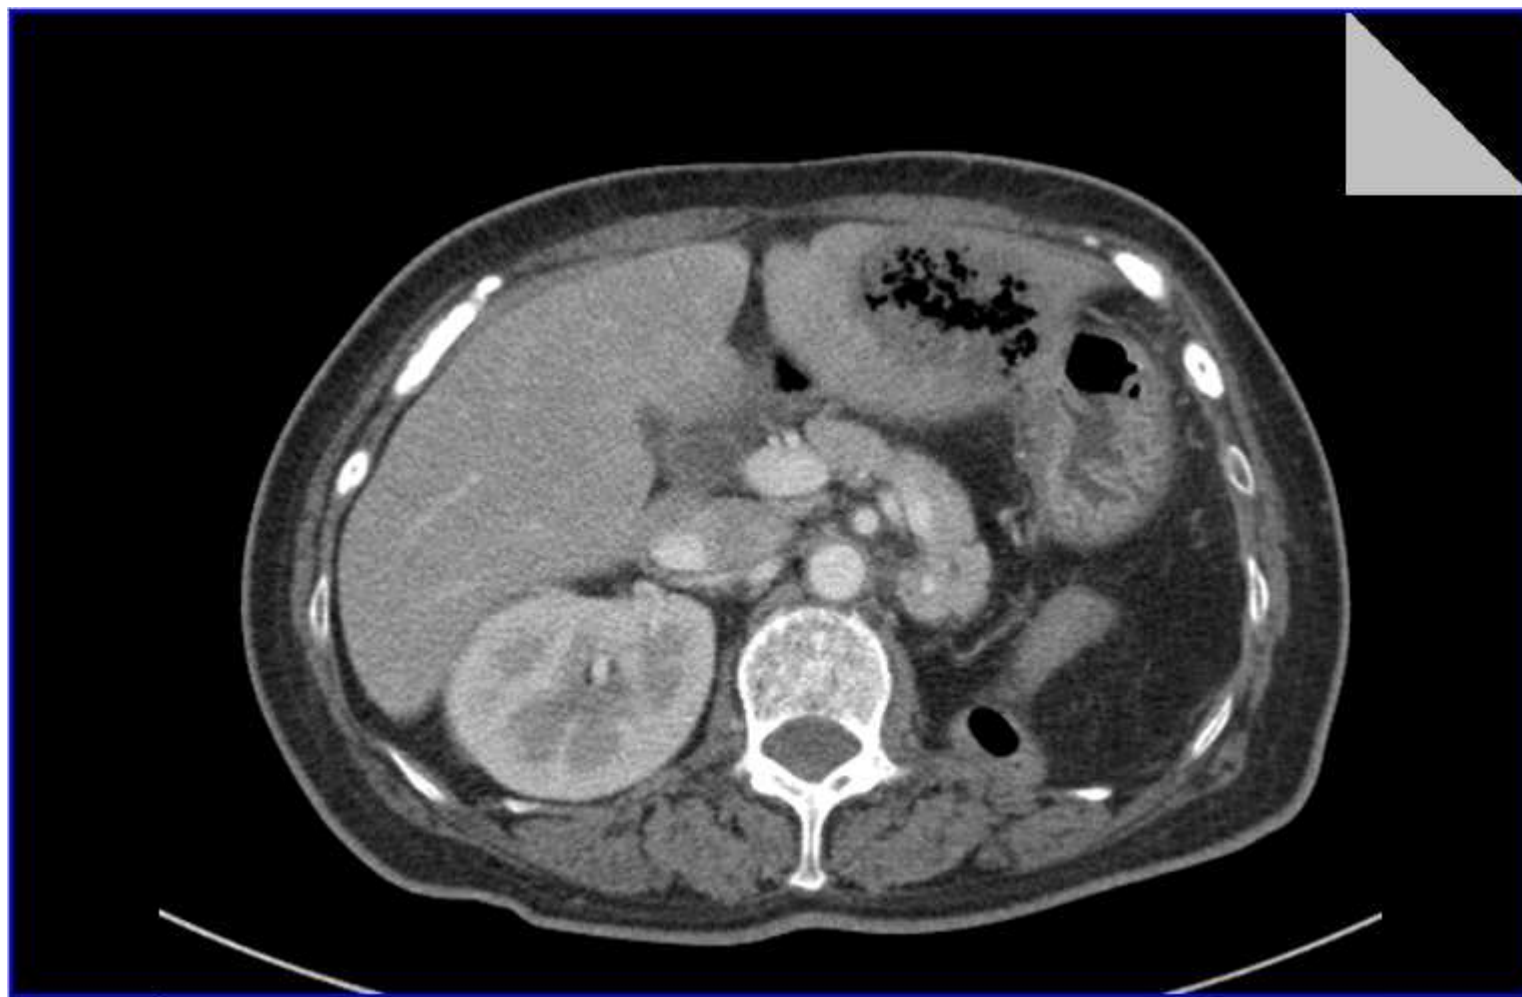



同日外科でドレナージ

2011/5/06

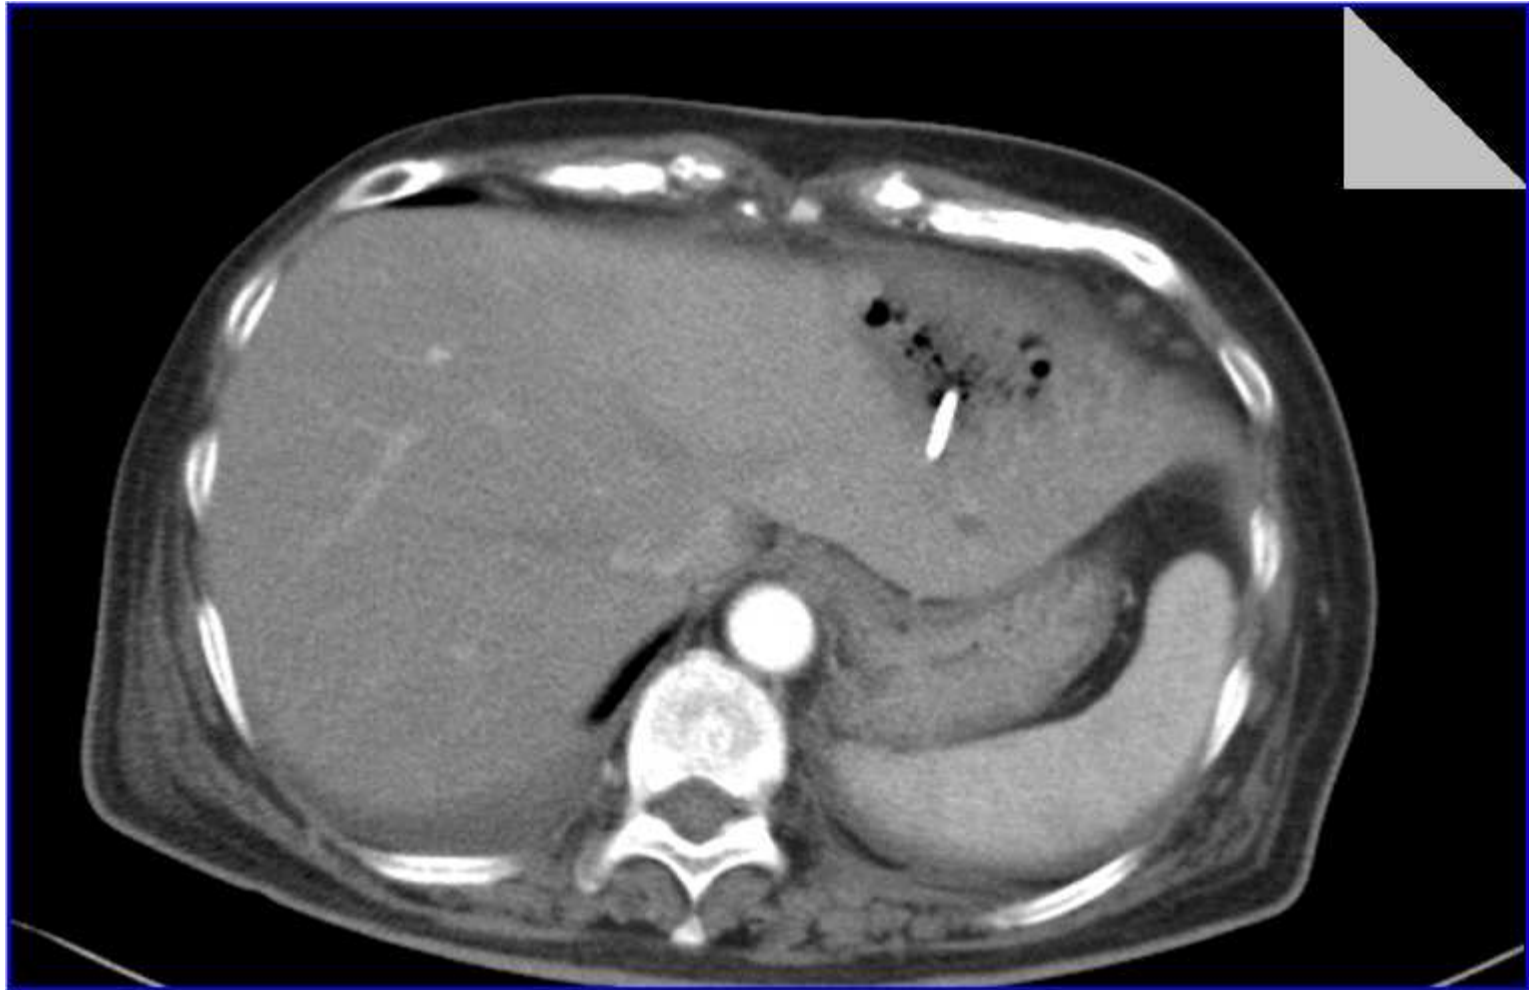



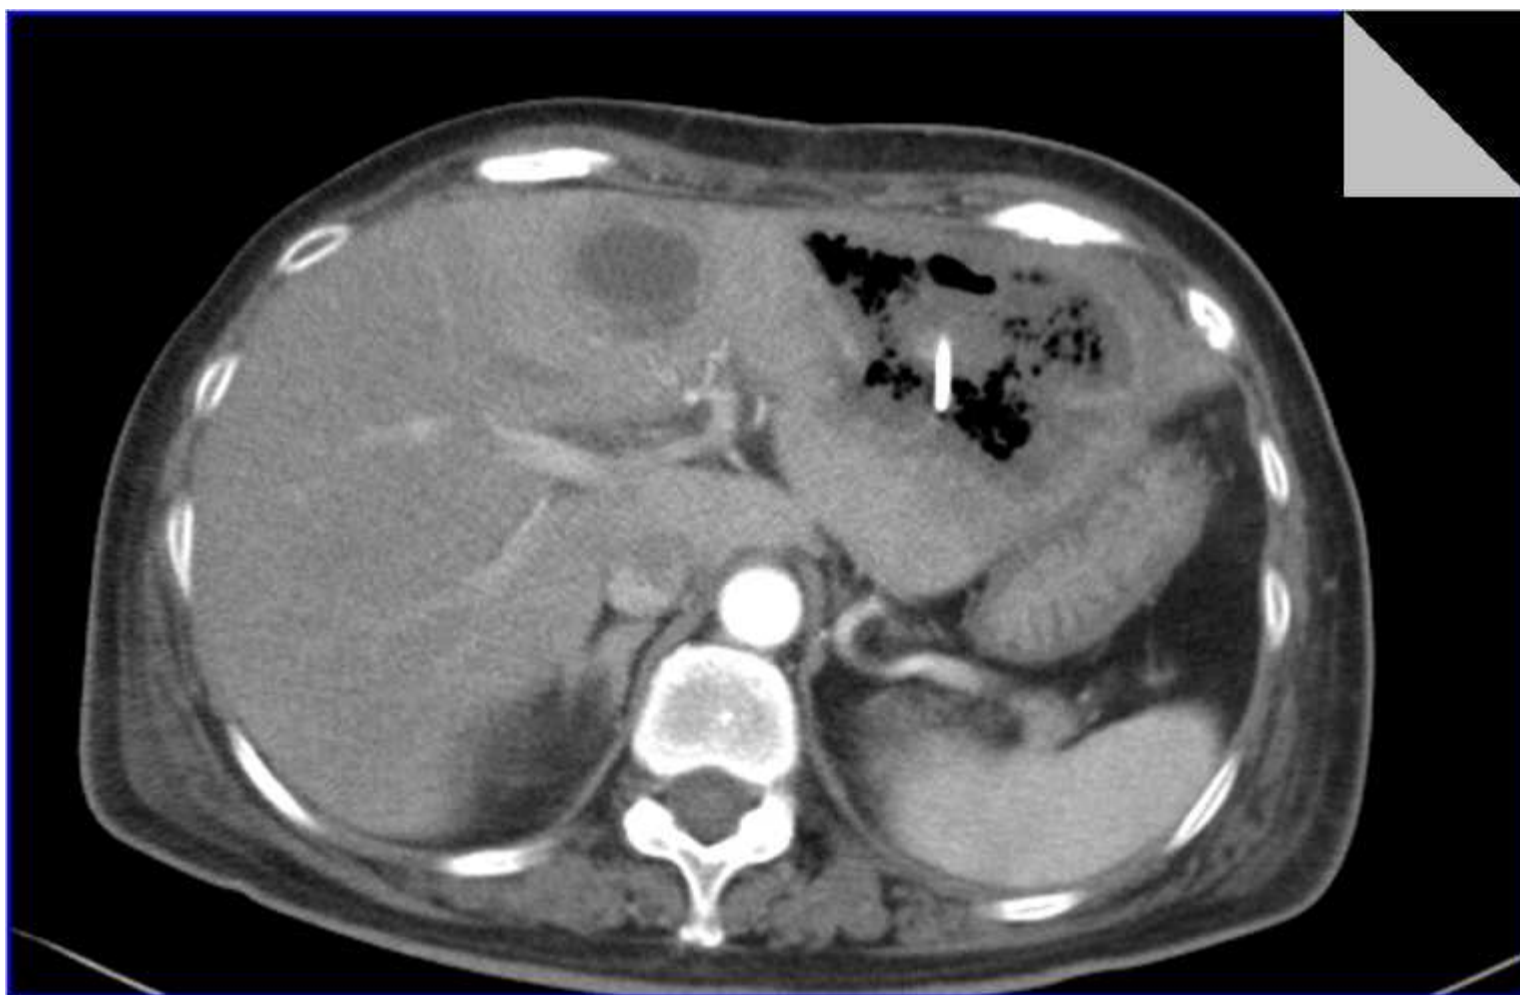

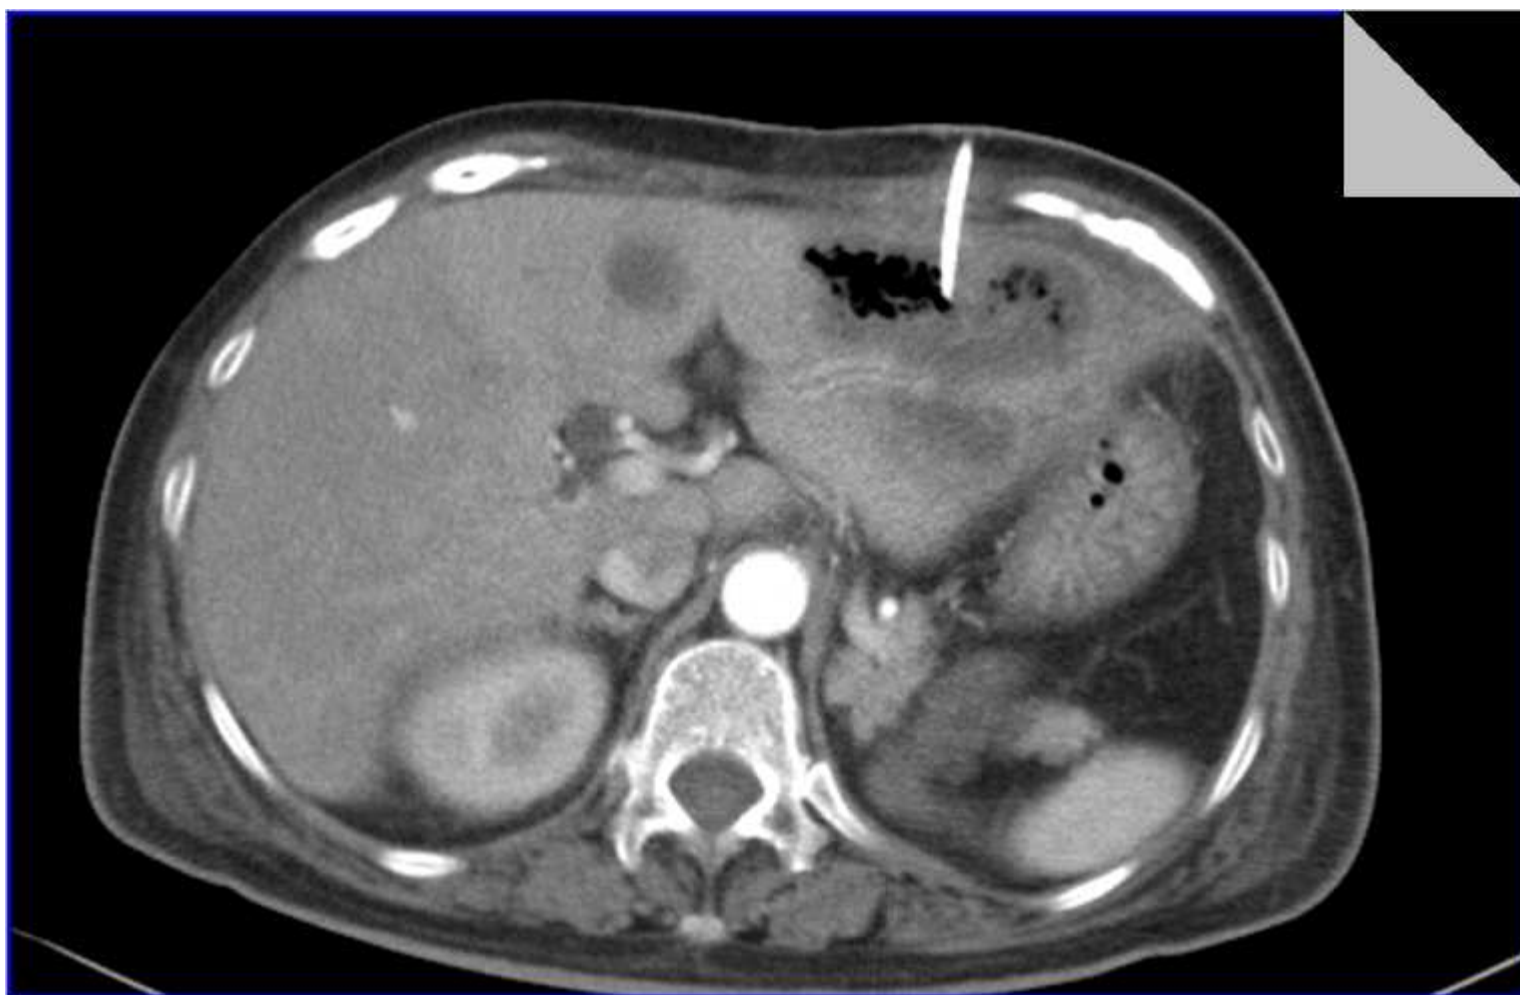




カンファレンスで
外側区のチューブを大口径に交換
S4のドレナージ
をすることに・・・


2011/5/17





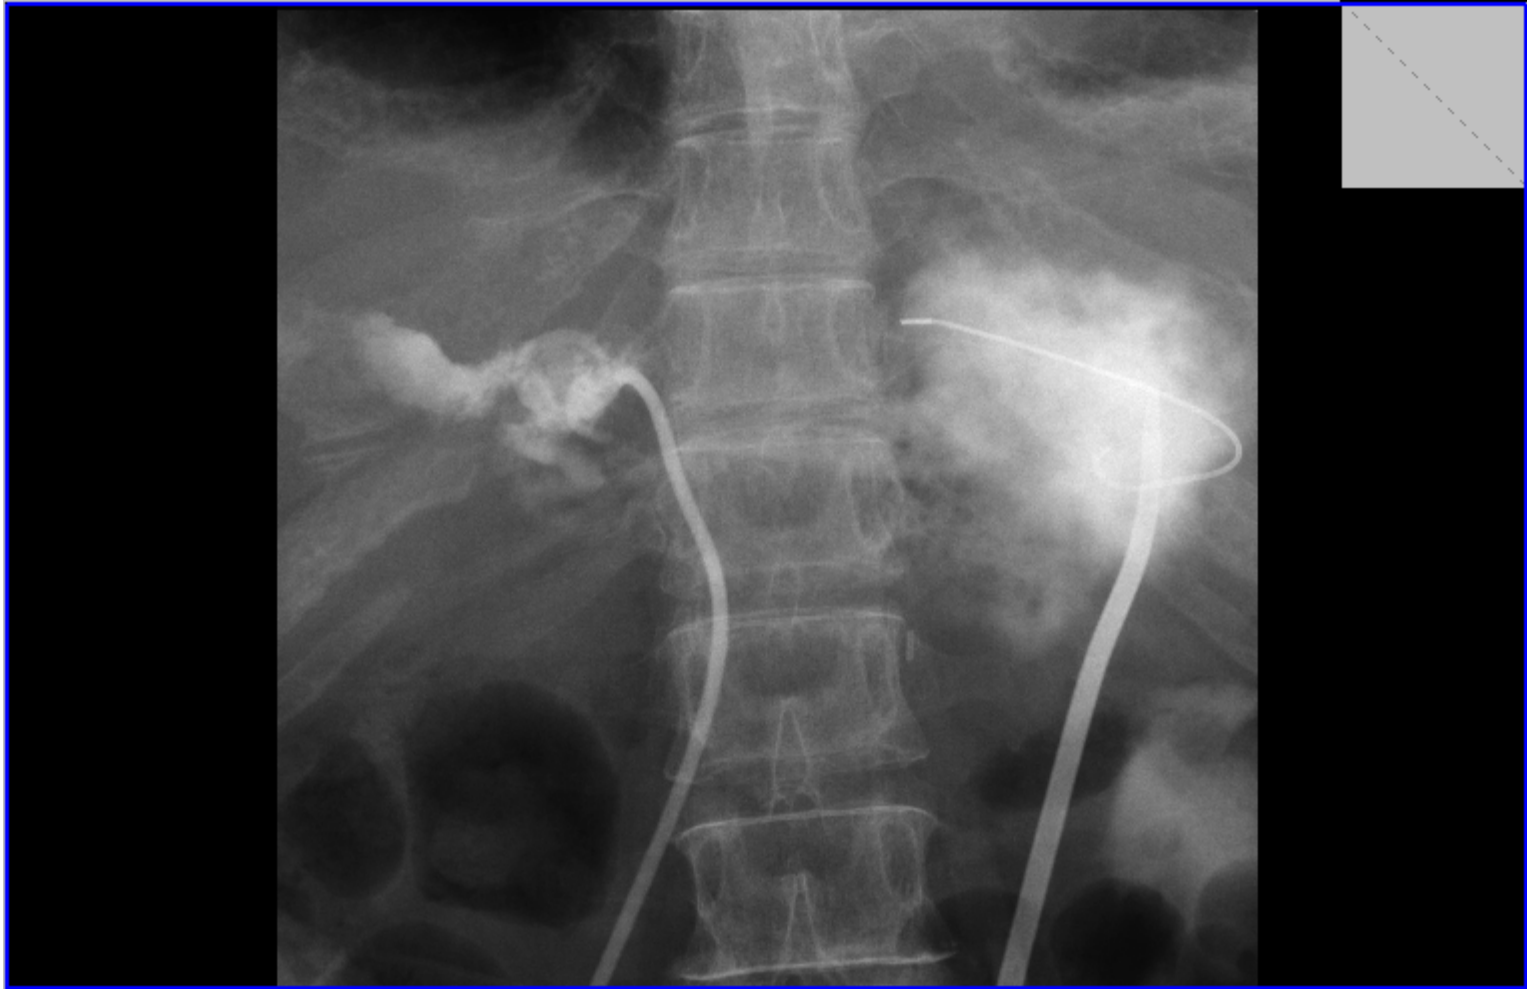


Manaco ECG 減圧器
 製品番号 20800BZZ00208000 高度
 ハナコ・ドレナージキット
 サイズ 7 Fr
 減圧ポート
 サイズ
 耐圧 kPa (psi)
 製品番号 (注文番号) (個)
 KIT-450
 特定保健医療材料適応分類
 P T C D カテ 1
 Lot No. 01200721115 減圧ポート 7208C10
 使用期限 2011.03 数量 1
 ■ 本製品は、使用前に必ず減圧器を確認してください。

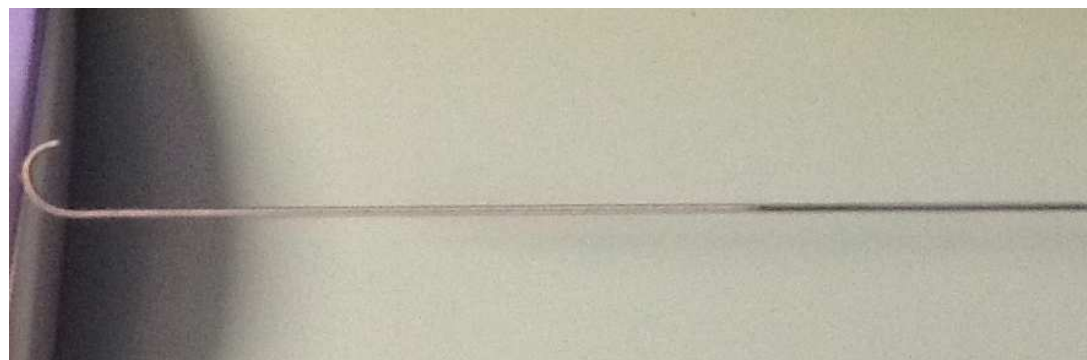



外科は経路拡張後、PTPS?で回収
を予定する方針


外科は経路拡張後、PTPS?で回収 を予定する方針


→経路拡張の際 透視下で回収を
させてください！

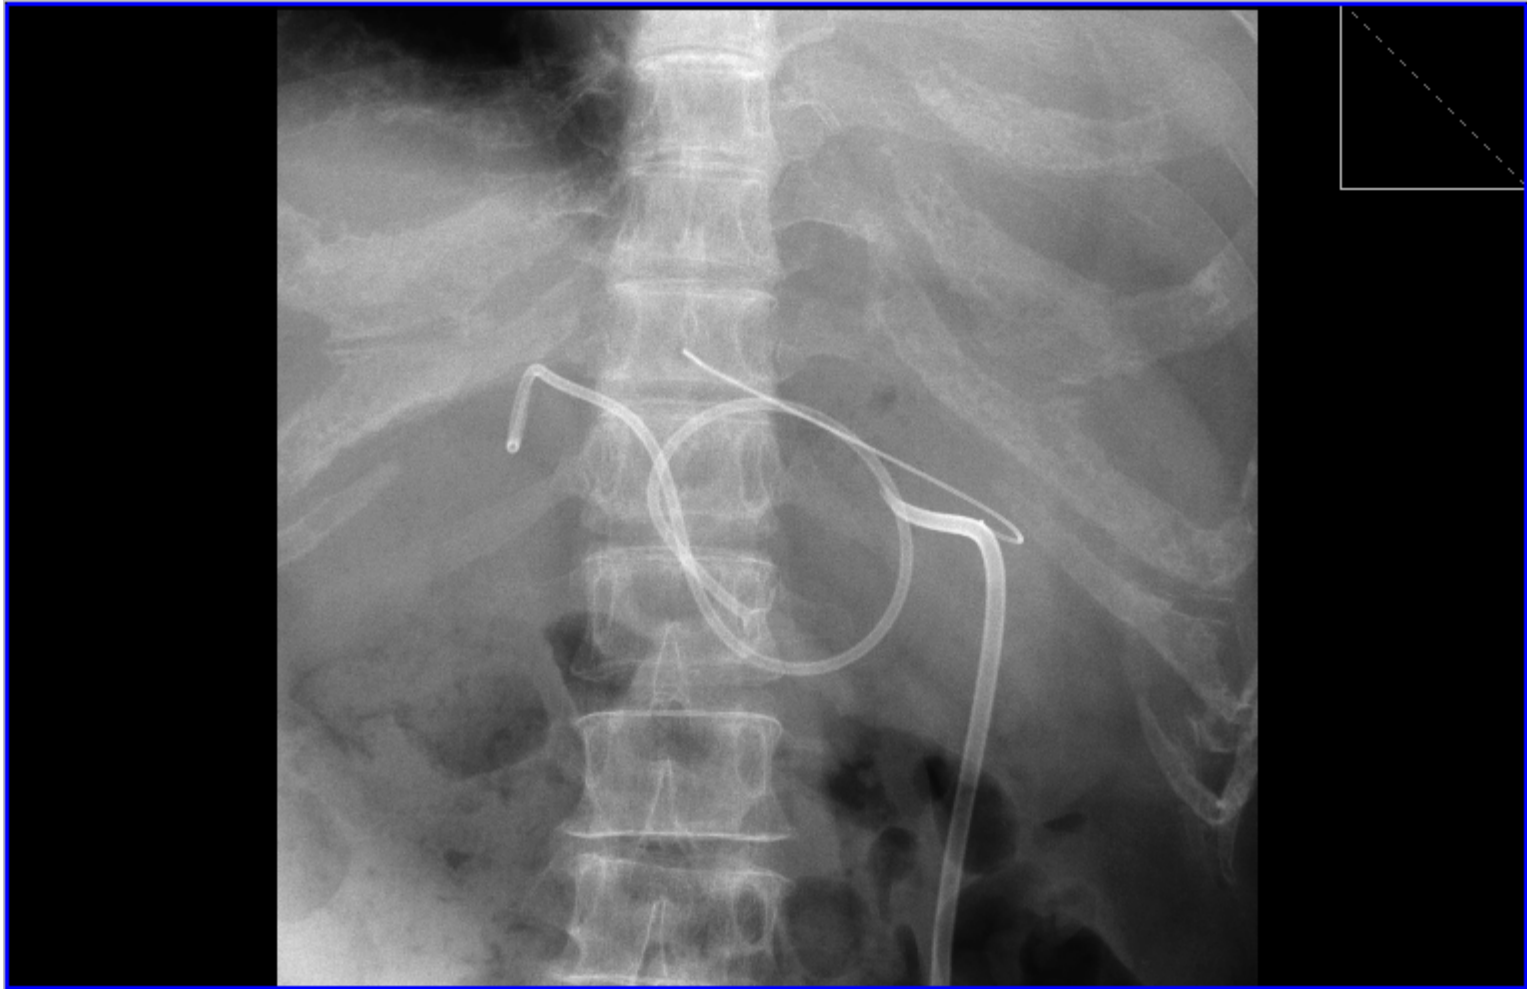

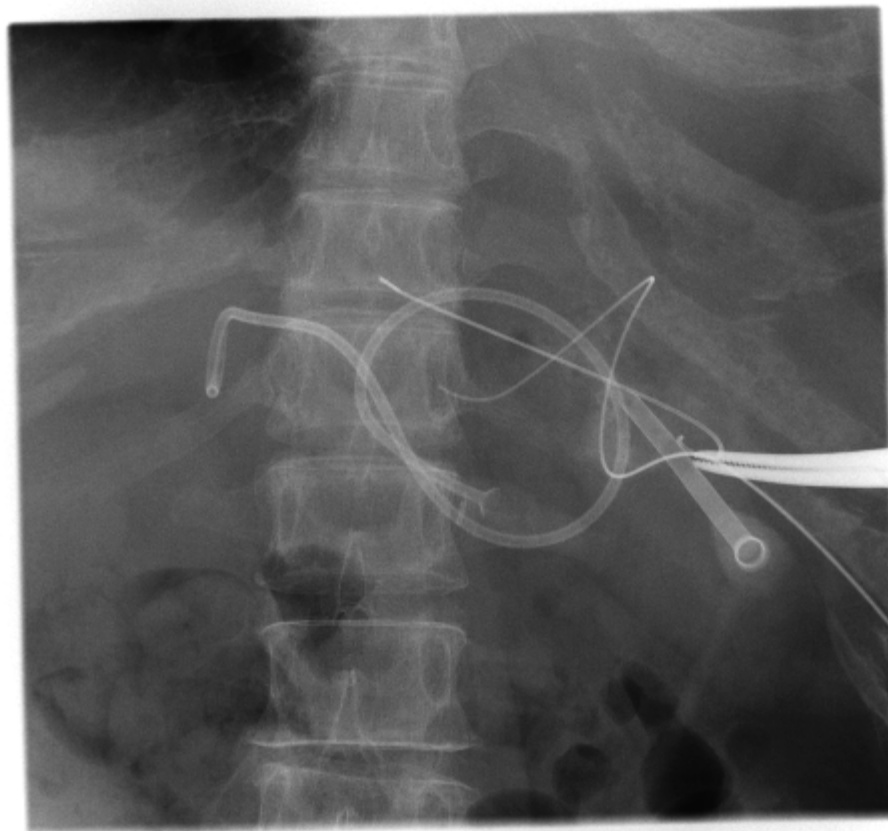

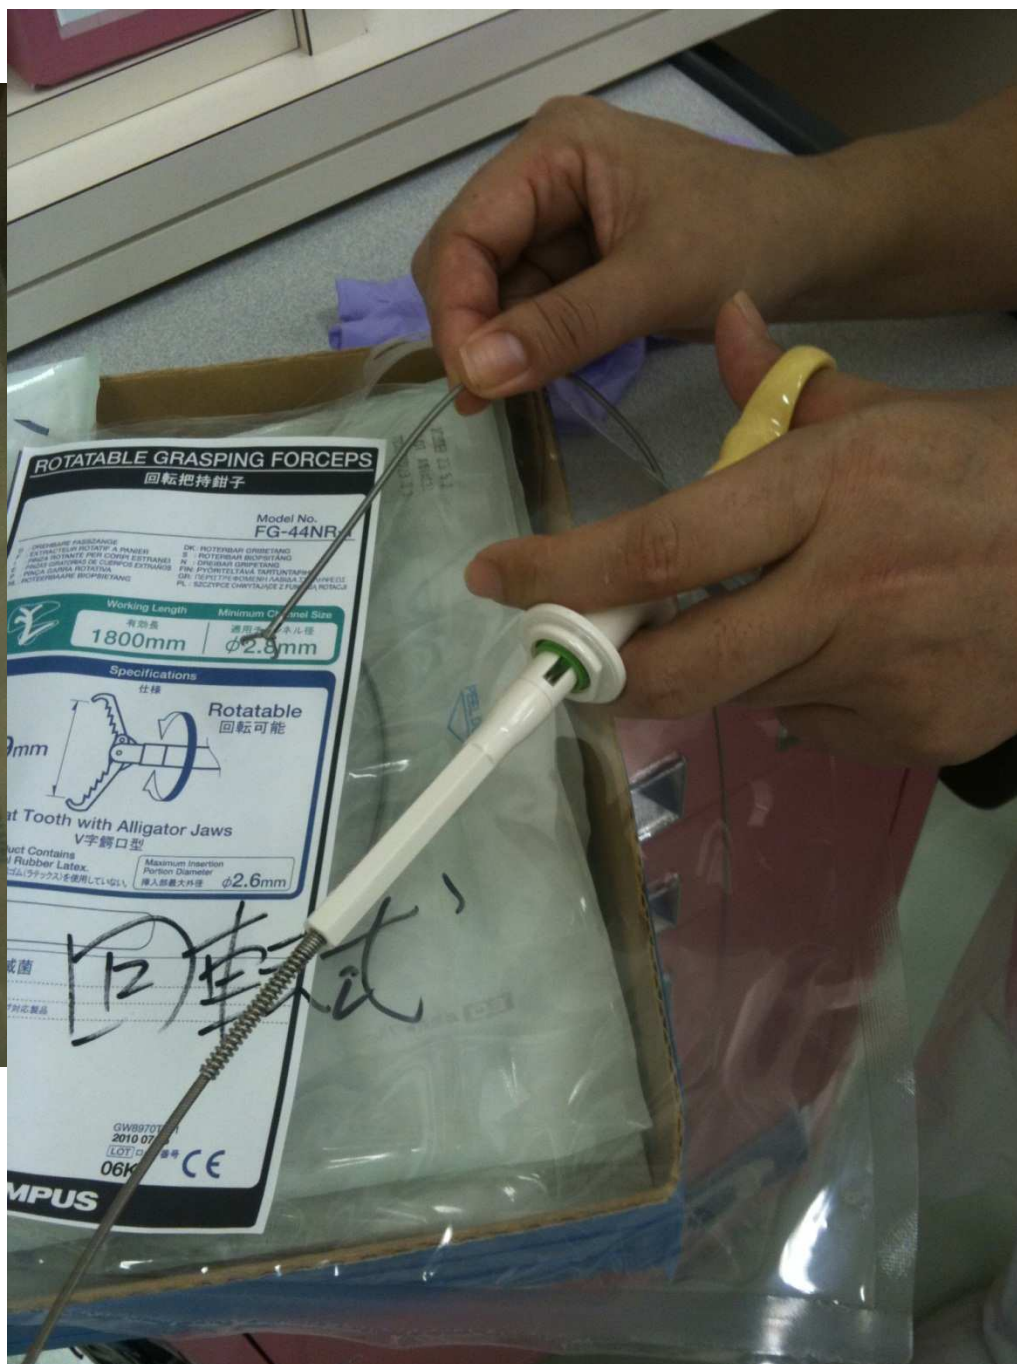

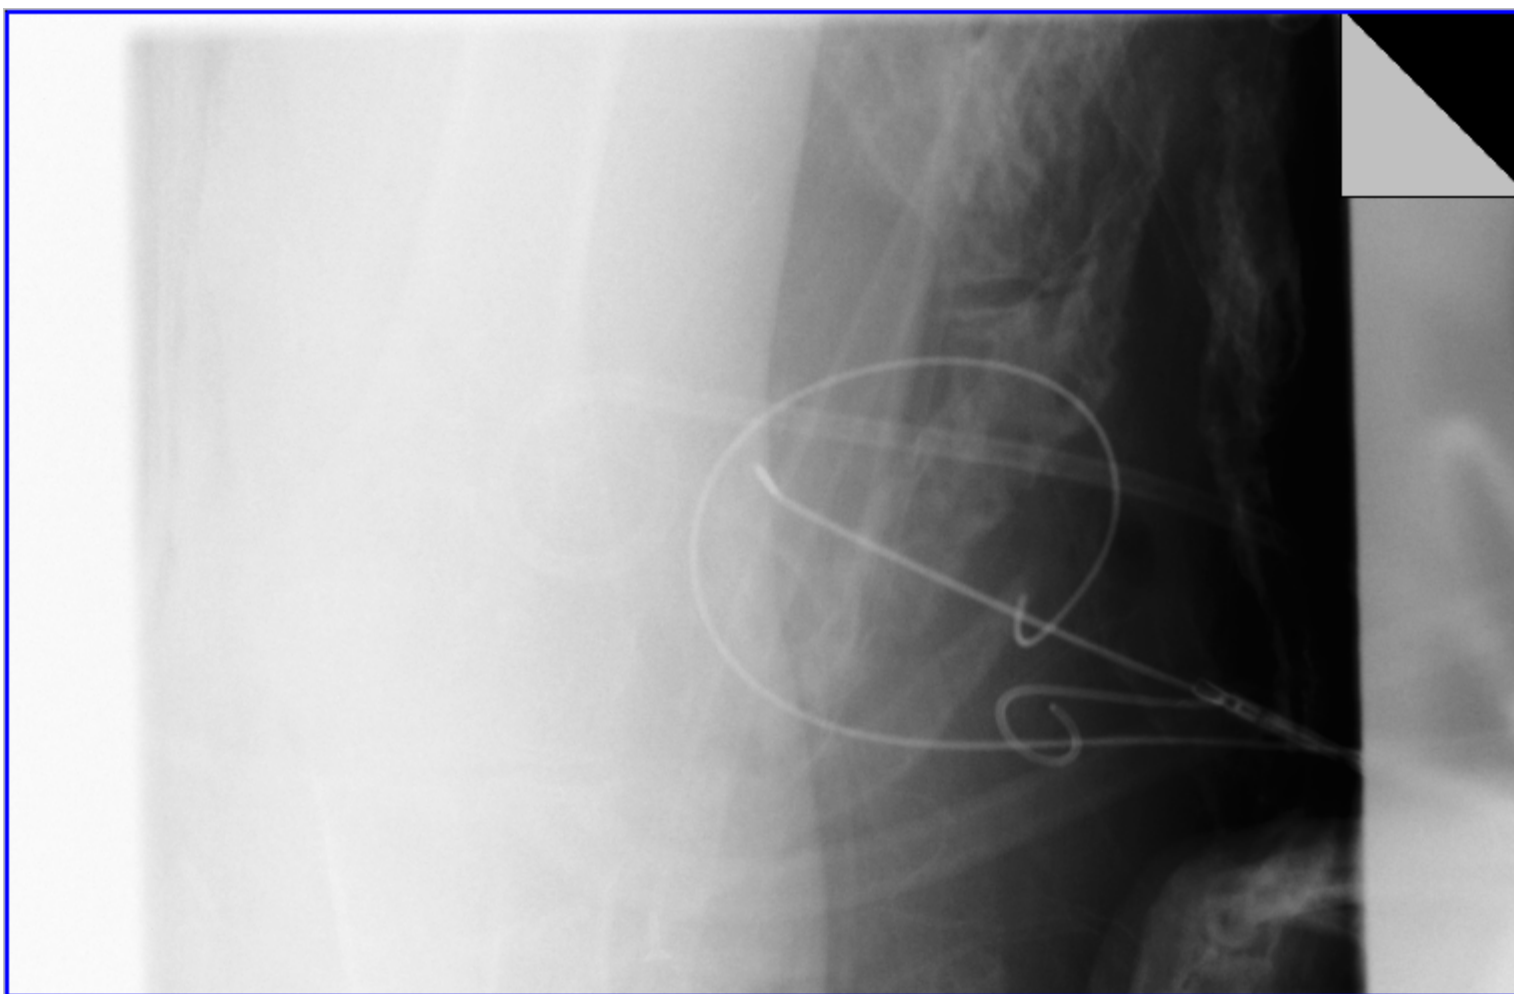

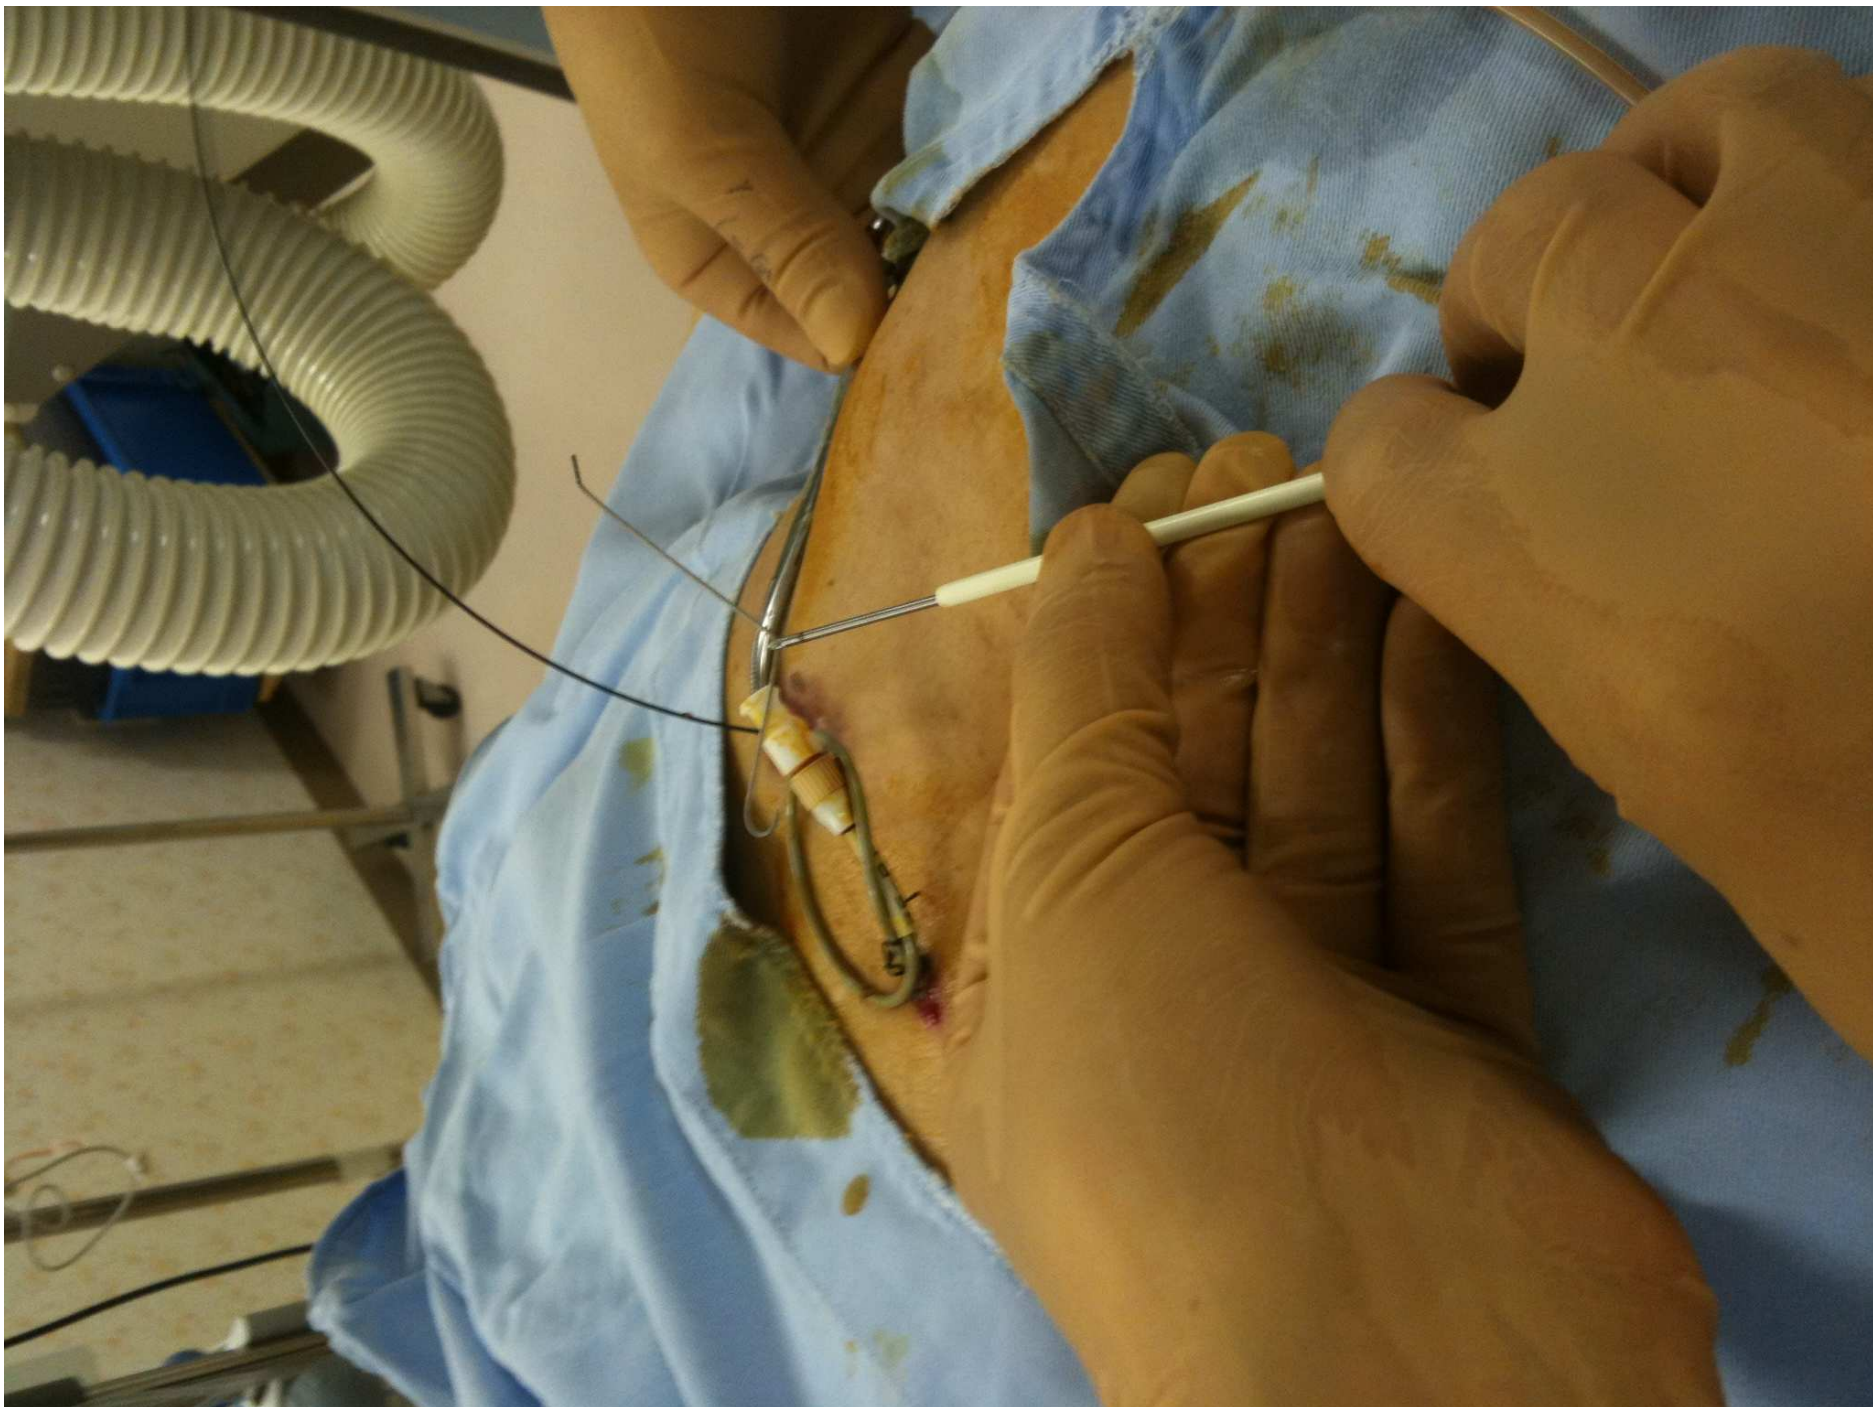



2011/7/16

